


INGEGNERIA CLINICA

CRITERI TECNICI PER PROPOSTE/PARERI DI SOSTITUZIONE

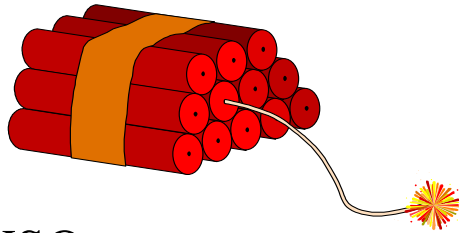

CRITERI PER DEFINIRE L'OBSOLESCENZA (ANIE-SIRM-AIMN)

- FUORI USO
- FUORI NORMA
- INAFFIDABILITA'
- MANUTENZIONE CRITICA
- OBSOLESCENZA
- COSTI DI GESTIONE ECCESSIVI
- VETUSTA'


Es. →

| Tipologia | Qualità | Sicurezza |
|--|---------|-----------|
| | Qualità | Sicurezza |
| Angiografi | 6,00 | 8,00 |
| Mammografi | 6,00 | 8,00 |
| MRI | 5,00 | 7,00 |
| Sistemi radiografia | 10,00 | 12,00 |
| TAC | 5,00 | 7,00 |
| Telecomandati | 7,00 | 9,00 |
| Sistemi per medicina nucleare – PET | 5,00 | 7,00 |
| Sistemi per medicina nucleare - Gamma Camera | 7,00 | 9,00 |
| Sistemi per medicina nucleare | 5,00 | 9,00 |

INGEGNERIA CLINICA

STRUMENTI PER LA PIANIFICAZIONE/ACQUISIZIONE

**CONOSCENZA
DEL
MERCATO**

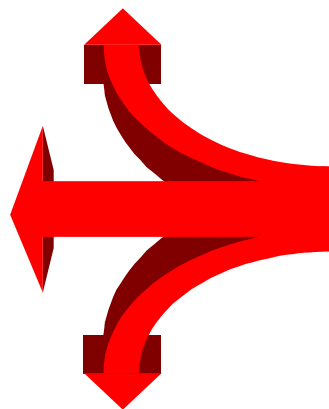

•APPROFONDIMENTI IN
FASE DI VALUTAZIONE

•INDIVIDUAZIONE
FORMA DI
ACQUISIZIONE PIU'
CONVENIENTE

•DEFINIZIONE
CAPITOLATO TECNICO




INGEGNERIA CLINICA

STRUMENTI PER LA PIANIFICAZIONE/ACQUISIZIONE



Attrezzature
sanitarie



Strutture e impianti

**CONOSCENZA DELLA REALTA'
OSPEDALIERA**

**Applicabilita' delle soluzioni nello
specifico contesto**



Organizzazione

e

gestione



Utilizzatori e
attività
cliniche





STESURA DEL CAPITOLATO REQUISITI DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE

Tipologie di contratto

- Full Risk: visite di manutenzione preventiva, tarature e prove funzionali come consigliato dalla casa costruttrice, verifiche di sicurezza conformemente alle norme CEI di pertinenza, interventi di manutenzione correttiva illimitati, ricambi inclusi;
- Manutenzione preventiva: visite di manutenzione preventiva tarature e prove funzionali come consigliato dalla casa costruttrice, verifiche di sicurezza conformemente alle norme CEI di pertinenza, ricambi previsti per tali visite inclusi;
- Fornitura Parti di Ricambio